CoaguChek® XS System

Oppstart

T

Roche

SETTE INN BATTERIER

1. Ta av batteridekselet

Åpne batterirommet på baksiden av instrumentet

2. Sett inn batteriene

Sett inn 4 AAA batterier som vist på diagrammet i batterirommet.

Rett etter at batteriene er satt inn må dato og klokkeslett legges inn.

Det er helt nødvendig at datoen stemmer. Hver gang en test utføres vil instrumentet sammenligne sine data med utløpsdatoen på teststrimlene. Dersom testene har gått, ut på dato, vises en feilmelding og man får ikke utført målingen.

Når det settes batterier inn i instrumentet vil det automatisk gå til innstilling av klokkeslett og dato. Du kan ellers komme til innstillingsmenyen ved å trykke på SET-knappen

STILLE INN DATO OG KL.

1. Start Setup

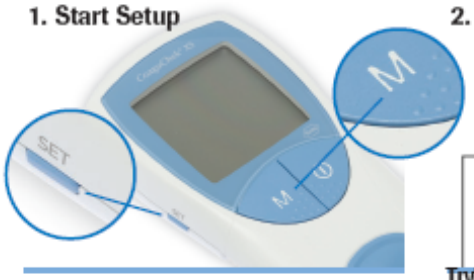

For å stille dato og klokkeslett bruk disse knappene: M for å endre eller for å akseptere en innstilling.

For å komme til innstillings-meny, trykk

The date format flashes in the upper right corner.

2. Still inn dato

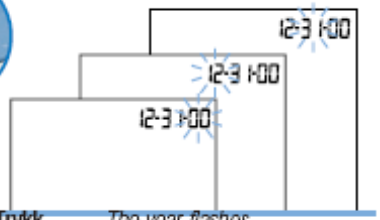

Trykk *The year flashes.*

M for å endre år og bekreft

M for å endre måned, bekreft

M for å endre dag, bekreft

The time format flashes in the upper left corner.

3. Still inn klokkeslett

Trykk *The hour flashes.*

M for å endre time, bekreft

M for å endre minutt, bekreft

Skru av apparatet

4. Sjekk skjermen

Trykk og hold PÅ/AV- knappen

Sjekk at alle bokstaver, tall og symboler på skjermen vises korrekt.

Slipp

Skru av apparatet

Bruksanvisning for CoaguChek XS

Sett inn teststrimmelen. Instrumentet skrus automatisk på

Sjekk kodenummeret i displayet mot nummeret på boksen og bekreft med M eller bytt kodebrikke dersom feil

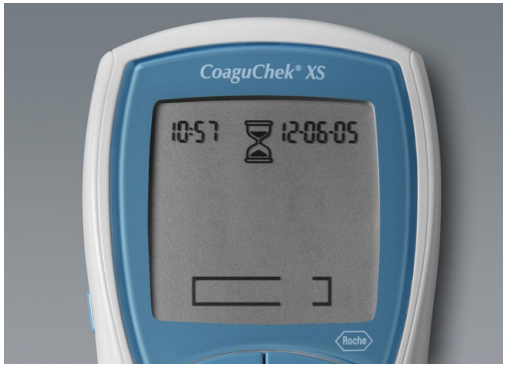

Et timeglass vises mens strimmelen varmes opp. Dette tar ca 30 sekunder

Når nedtelling fra 180 starter er det klart til å legge på blodprøven

Bruk Softclix til å stikke i fingeren med. Stryk/masser forsiktig langs fingeren for å få frem en bloddråpe. Unngå klemming

Bruk første bloddråpe og legg den på strimmelens blanke felt (eller la den suges inn fra en av sidene) innen 15 sek.

Mens målingen pågår sjekkes også strimmelens kvalitet. QC √ betyr at strimmelen er OK

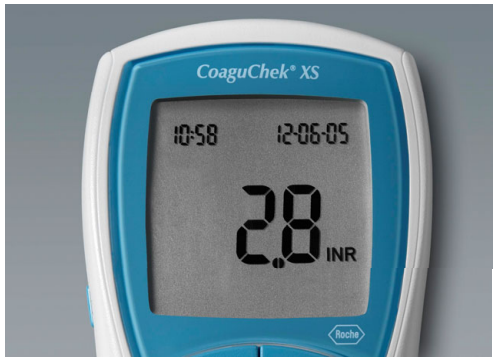

Resultatet vises på skjermen etter ca 1 minutt. Alle resultater lagres i minnet med dato/kl. og kan hentes frem med M-knappen